

GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

ANEXO I

Termo de Referência

Pregão Eletrônico n.º 2022.02.24.1



TERMO DE REFERÊNCIA

1 - OBJETO DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Farias Brito/CE.

2 - JUSTIFICATIVAS

2.1. CONTRATAÇÃO

2.1.1. A presente aquisição visa dotar as Unidades Básicas de Saúde, o Hospital Geral e o Centro de Reabilitação Albino Oliveira de materiais e equipamentos que são imprescindíveis para a regular e eficiente execução dos serviços de saúde oferecidos aos usuários da Rede Pública Municipal de Saúde.

2.2. DIVISÃO POR LOTES

2.2.1. Quanto à composição dos lotes, temos que os itens foram agrupados por "LOTES" em virtude dos mesmos guardarem compatibilidade entre si, ou seja, estão divididos pela semelhança, agrupando itens similares e específicos, guardando a devida especificidade de cada objeto, observando-se, inclusive as regras mercadológicas para a prestação dos serviços, de modo a não prejudicar a concorrência entre os participantes, mantendo a competitividade necessária à disputa.

2.2.2. No que diz respeito ao Princípio da Economicidade e em contratar a proposta mais vantajosa, individualizar a contratação do aludido objeto sobrecarrega a Administração Pública e encarece o contrato final, uma vez que os licitantes possuirão uma margem de negociação bem maior por estarem comercializando uma maior parcela (Lote) do objeto licitado. Dessa forma, na divisão em lotes do objeto em tela, há um grande ganho para a Administração na economia de escala, tendo em vista que implicaria em aumento de quantitativos e, conseqüentemente, numa redução de preços a serem pagos pela Administração.


2.2.3. Isto posto, adotamos o julgamento do tipo "MENOR PREÇO POR LOTE", por entendermos que a contratação dessa forma será mais conveniente, aumentará a uniformidade dos valores e fornecimentos, e reduzirá os riscos de conflitos. Além disso, por se tratar de licitação do tipo menor preço por lote, os valores unitários de cada item ainda assim deverão ser levados em consideração, evitando-se distorções nos valores para cada item em vistas a realidade mercadológica.

3 - ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E VALOR ESTIMADO

3.1 - A empresa a ser contratada, deverá fornecer os produtos conforme descrição na planilha anexa a este Termo de Referência.

3.2 - Conforme exigência legal, o Município de Farias Brito realizou pesquisas de preços de mercado e estimativa de custos junto a empresas atuantes no ramo do objeto licitado, utilizando-se como base legal a Instrução Normativa nº 73, de 05 de Agosto de 2020.

3.3 - O valor máximo admitido para esta aquisição é de **R\$ 937.085,21 (novecentos e trinta e sete mil oitenta e cinco reais e vinte e um centavos)**. Foi utilizado como metodologia para obtenção do preço estimado para a futura contratação o menor dos valores obtidos nas pesquisas de preços; conforme Art. 6º da supracitada instrução.



GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

4 - ORIGEM DOS RECURSOS

4.1 - As despesas do futuro Contrato correrão por conta de recursos oriundos do Tesouro Municipal, previstos nas Dotações Orçamentárias discriminadas no Edital Convocatório.

5 - PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

5.1 - O presente Contrato terá vigência até 31/12/2022, a contar da data de sua assinatura, ou enquanto decorrer o fornecimento dos produtos dentro da vigência do mesmo.

6 - ENTREGA DOS PRODUTOS E DO RECEBIMENTO

6.1 - Os produtos serão fornecidos de acordo com as solicitações requisitadas pela contratante, devendo os mesmos serem entregues junto à sede das mesmas, ou onde for mencionado nas respectivas Ordens de Compra, ficando a Administração no direito de solicitar apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessária, sendo as despesas com a entrega de responsabilidade da empresa Contratada.

6.2 - Os produtos deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da respectiva Ordem de Compra.

6.3 - A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, os produtos que vierem a ser recusados por justo motivo, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação.

6.4 - A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto, sendo que os produtos deverão estar todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da data de industrialização e o prazo de validade, quando for o caso.

6.5 - Caso a Prefeitura venha optar por entrega programada a contratada deverá dispor de instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos.

6.6 - O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos:

6.6.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a especificação;

6.6.2 - Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do produto, pelo setor responsável pela solicitação e consequentemente aceitação.

7 - DO PAGAMENTO


7.1 - O pagamento dos produtos fornecidos será efetuado pela Administração, mensalmente, obedecidas as requisições, em moeda corrente, conforme o valor apresentado na fatura correspondente e certificado pelo setor competente limitando-se o desembolso máximo em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros do Tesouro Municipal, em prazo não superior a 30 (trinta) dias.

7.2 - O pagamento será efetuado através de Transferência Bancária.

8 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 - As obrigações do(a) CONTRATADO(A) são as discriminadas na Minuta Contratual, parte integrante do Edital, independente de sua transcrição.

[Handwritten signature]




GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

9 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1 - As obrigações da CONTRATANTE são as discriminadas na Minuta Contratual, parte integrante do Edital, independente de sua transcrição.

FARIAS BRITO/CE, 23 de fevereiro de 2022.

Maria Marcleide do Nascimento Laet Rafael
Secretária Municipal de Saúde



GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos


ORÇAMENTO BÁSICO

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total
LOTE 01 - MATERIAIS/EQUIPAMENTOS					
1	Computador - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org , organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão	Und	25	6.697,98	167.449,50
2	Computador (Desktop - Básico) - especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel Core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabytes; memória Ram de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX, ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org , organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT OU DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD,DVD rom; teclado USB, Abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, Scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) interfaces de rede 10/100/1000 e Wi fi padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema	Und	25	7.619,00	190.475,00




GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

	operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir graduações neutra das cores branca, preta ou cinza, e manter e mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.				
3	Impressora Laser – especificações mínimas: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/1000 ethernet e WiFi 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.	Und	5	3.809,00	19.045,00
4	Notebook – especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com processador no mínimo Intel Core i5 ou AMD a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 GIGABYTES velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD Rom; memória RAM de 8 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior, tela LCD de 14 ou 15 Polegadas Widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão UBS e botão de rolagem (scroll); interface de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 ^a a/b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); bateria recarregável do tipo íon de lítio com no mínimo 06 (seis) células; fontes externas automática compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port 01 (uma) VGA, leitor de cartão; webcam FULL HD (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.	Und	1	8.809,00	8.809,00
					385.778,50
LOTE 02 - MATERIAIS/EQUIPAMENTOS					
1	Ar condicionador 12.000 btus - especificação: condicionado slip, inverter, quente e frio, branco, características baixo ruído, controle remoto, desumidificação, filtro antivírus, função sleep, selo procel, classe A, compressor, consumo (kw/h) 17,01. vazão de ar 500,timer, filtro de proteção ativa, direcionadores de ar saída regulável do ar, painel eletrônico, controle de temperatura, voltagem 220v/110v, conteúdo da embalagem: unidade evaporada,1 controle remoto, dimensões aproximadas do produto – cm (axlxp) 26,2x79x19,5cm, garantia do fornecedor.	Und	12	2.351,50	28.218,00
2	Ar condicionador 9.000 btus - especificação: condicionado slip, inverter, quente e frio, branco, características baixo ruído, controle remoto, desumidificação, filtro antivírus, função sleep, selo procel,	Und	6	2.598,60	15.591,60




GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

	classe A, compressor, consumo (kw/h) .timer, filtro de proteção ativa, direcionadores de ar saída regulável do ar, painel eletrônico, controle de temperatura, voltagem 220v/110v, conteúdo da embalagem: unidade evaporada, 1 controle remoto, garantia do fornecedor.				
3	TV. tamanho de tela: 32 polegadas . Resolução: HD (1366 x 768p) Sistema Operacional: Saphi. Frequência: 60 Hz. Potência de áudio: 10 Watts RMS. Conectividade: HDMI (2x), USB (2x) e Wi-Fi.	Und	10	2.600,00	26.000,00
4	GELADEIRA - Refrigerador doméstico com capacidade mínima de 275 litros - , Capacidade mínima do refrigerador 215 lt, e capacidade mínima do freezer de 60 lt, cor branca, Contendo: porta ovos, controle de temperatura, pés reguláveis, bivolt. Eficiência de energia: tipo A.	Und	12	2.529,10	30.349,20
5	Bebedouro de Coluna Gelágua - especificação: dimensões aproximadas do produto: 220v altura: 1.01 m largura: 32.00 cm profundidade: 32.00 cm profundidade: 32.00 cm, cor branco, tipo de água: garrafão, material de plásticos e aço, com 02 torneiras, bandeja de água removível.	Und	10	970,00	9.700,00
6	VENTILADOR. Fonte de alimentação: energia elétrica; número de velocidades: 3; número de lâminas: 6; Tensão: 220 volts; comprimento de lâmina: 47 centímetros	Und	10	219,98	2.199,80
					112.058,60
LOTE 03 - MATERIAIS/EQUIPAMENTOS					
1	ANALISADOR DE IONS/ ELETROLITOS BIOCLIN IONS K+, NA+, CL-, CA2+, PH - R10050	Und	1	20.800,00	20.800,00
2	ANALISADOR DE URINA URIVISION 100 - WAMA - CÓD 01871	Und	1	11.200,00	11.200,00
3	ANALISADOR IMUNOLOGICO FINECARE FIA METER PLUS CELER - CÓD. 02995	Und	1	17.819,00	17.819,00
4	APARELHO PARA HEMOSSEDIMENTACAO VHS TIMER - MARCA CLOT	Und	1	4.918,00	4.918,00
5	ASPIRADOR CIRÚRGICO 6L COM FRASCOS AUTOCLAVÁVEL MD600, Tensão 127/220V Bivolt automático, 60 Hz, Fusível 3A, Capacidade do frasco coletor 3,0 litros cada frasco. Dimensão do aparelho C: 450 x L: 485 x A: 1040 mm, Potência nominal total 200W ou aprox. 1/4 CV +/- 8%, Proteção térmica Sim. Tipo de proteção contra choque elétrico Aspirador de classe /Pedal classe II	Und	4	8.104,00	32.416,00
6	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO ESMALTADO, Estrutura tubular em aço redondo;- Cortinas em plástico pvc 0,20 branco, Pés com rodízios giratório de 2" de diâmetro, Dimensões: 1,82m largura aberto x 0,66m largura fechado x 1,77m altura x 0,50m comprimento;Peso: 10 KG.	Und	4	540,00	2.160,00
7	BISTURI ELÉTRICO HF-120 Características: 6 funções: corte puro, blend 1, blend 2, blend 3, coagulação e bipolar. Display digital que indica potências. Memória não volátil, Sistema de monitoramento de circuito com alarme e reconhecimento automático de placa-paciente comum ou bipartida. Produto certificado de acordo com a norma NBRIEC 60601-2-2, incluindo teste de interferência eletromagnética (EMC) - Classe CF Dimensões: 15 cm (A) x 24,5 cm (L) x 26 cm (P), Peso: 3,5 Kg, Registro Anvisa: N.º: 10247670035, Alimentação: 127 / 220 VAC – 50/60 hz	Und	1	22.400,00	22.400,00
8	CENTRIFUGA LABORATORIAL - Microprocessada Digital 24 Tubos 10ml	Und	1	4.909,10	4.909,10




GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

9	COAGULOMETRO MAX COAG 1 CANAL C/ PIPETADOR	Und	1	14.400,00	14.400,00
10	DESTILADOR DE AGUA CRISTÓFOLI, Destilador de água Cristófoli · Desenvolvido para destilar água para uso em autoclaves de esterilização a vapor, Capacidade: 4 litros, Dimensões: 27 x 33 x 27,6 cm (L x A x P), Voltagem: 127 V ou 220 V. Frequência: 50/60 HzAlimentação Elétrica, Registro ANVISA, Capacidade do Reservatório - Água Destilada 3,8L, Reservatório - Água Comum 4 LTempo de Ciclo Aproximado 6 - 8 horas	Und	1	1.163,64	1.163,64
11	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL - sensibilidade a partir de 10-12 semanas; transdutor de alta sensibilidade; alto-falante de alta performance; entrada para fone de ouvido, gravador de som ou computador; botão liga/desliga e controle de volume e desligamento automático; tela de lcd com indicador de batimento cardíaco fetal e bateria fraca no display, bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento (bivolt); dimensões aproximadas: 33mm x 117mm x 131 mm, performance fhr: faixa de medição: 50-240 bpm; resolução: 1bpm; precisão: ± 1 bpm; saída de energia: 20mw. transdutor: frequência nominal: 2.0mhz; frequência de operação: 2.0mhz ± 10%; p-: <1mpa; lob: <20 mw/cm²; ispta: <100 mw/cm² , intensidade de saída de ultrassom: isata <10 mw/cm²; área de radiação efetiva do transdutor: 154mm², garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.	Und	14	546,00	7.644,00
12	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL FD200B Transdutor de alta sensibilidade. Design ergonômico e compartimento para transdutor. Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador.Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal. Alimentação através de pilhas alcalinas. Certificado pelo INMETRO.	Und	2	546,00	1.092,00
13	Eletrocardiógrafo digital de 12 canais e 12 derivações simultâneas CARDIOCARE 2000 - Laudo interpretativo, Impressão em papel termo-sensível milimetrado,papel comum A4, Velocidade de avanço do papel ajustável entre 25mm/seg e 50mm/seg, operação em modo manual e modo automático, Aquisição das 12 derivações, Display com visor de cristal líquido digital, Proteção contra descarga de desfibriladores, Atualização do software pela internet gratuitamente	Und	1	9.600,00	9.600,00
14	FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL, LED95220 V / 50 HZ, Foco Cirúrgico Auxiliar LED, Equipamentos projetados e montados seguindo normas nacionais e internacionais de segurança elétrica e gerenciamento de riscos, Possui haste giratória, Rodízios em material resistente, aço tratado com banho antioxidante e antiferrugem. Pintados em epóxi a 250º Célsius com acabamento em poliestireno de alto impacto. Sistema de iluminação com LED, iluminância é de 31.000 lux a 75 cm e 24.000 lux a 100 cm de distância, ajuste fixo com diâmetro de foco correspondente a: "d50=100 mm". Vida útil mínima esperada para os LED'S de 35.000 horas e média de 50.000 horas.Normas: NBR IEC 60601-1 e ABNT NBR IEC 60601-1-2., selo do INMETRO.Manopla removível e autoclavável.	Und	1	800,00	800,00
15	FOCO PARA PREVENÇÃO. Composição de aço carbono, leve (2,4 kg) e de alta durabilidade porque não enferruja. Haste flexível para melhor direcionamento da lâmpada. Altura regulável de 110 a 135	Und	10	639,82	6.398,20



GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos


	cm.Acompanha lâmpada Led fria e branca 6w bivolt. Base com rodinhas para facilitar locomoção.				
16	KIT CPAP AIRSENSE 10 + UMIDIFICADOR RESMED + MÁSCARA YUWELL ORONASAL VIEW ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, Uso Adulto, Diâmetro da válvula: cotovelo de 22mm, Quadro central, válvula/cotovelo e cliques em policarbonato e polipropileno. Almofada em silicone, DIMENSÕES DA MÁSCARA: Tamanho P e M.	Und	1	5.312,00	5.312,00
17	KIT VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO OXIGÊNIO, Escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 Mpa (0 à 315 Kgf/cm ²), Conexões de entrada e saída: Latão cromado, Manômetro: Aço com pintura epóxi. - Conexões de entrada e saída, conforme as normas ABNT.	Und	5	320,00	1.600,00
18	MICROSCOPIO LABORATORIAL.	Und	1	4.860,00	4.860,00
19	MONITOR MULTIPARÂMETROS INMAX 12" BÁSICO INSTRAMED. Cód. Ref.7547, acesso simples e rápido, observar as frequências cardíacas, garantia da marca Instramed.	Und	1	16.197,00	16.197,00
20	NEGATOSCOPIO. Negatoscópio De 01 Corpo, Modelo Simples-Destinados A Simples Visualização Ou Para Fins De Diagnóstico De Imagens Analógicas Ou Digitais; Construído Em Chapa De Aço; Pintado Eletrostaticamente Nas Cores Cinza, Branco, Bege Ou Preto; Parte Frontal Em Acrílico Translúcido Branco Leitoso; Iluminação Através De Duas Lâmpadas Fluorescentes De 15W 6500K Por Corpo; Acionamento Por Reatores Eletrônicos De Alto Fator De Potência; Luminância Aproximada De 2000 Nits; Acendimento Através De Interruptor; Disponível Em 110V ou 220V; Dimensões Externas: 380X100X485Mm; Dimensões Área De Leitura: 360X410Mm; Grupo:Padrão;Altura:485; Largura:100 mm; Comprimento:380 mm	Und	5	412,73	2.063,65
21	Otoscópio Simples - iluminação branca e de alto brilho; possibilita avaliar a mobilidade da membrana timpânica; reostato para controle de intensidade da luz; não contém látex; transmissão da luz direta; lâmpada: vácuo, halógena ou led; material da cabeça: metal; material do cabo em metal; acabamento do cabo recartilhado; tensão 2.5v; alimentação: 2 pilhas tipo c; lente de aumento 4 vezes; acompanham o produto: 05 espúculos auriculares autoclaváveis (2.5, 3.5, 4.5, 5.5 e 9mm) 01 estojo macio para otoscópio e seus acessórios; garantia do equipamento: 1 ano.	Und	17	482,00	8.194,00
22	Oxímetro de Pulso Portátil de Mão - tela com LCD colorido de alta resolução, indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabelas de tendência. Aparelho portátil e leve, com baterias e sensor. Tela rotacional, permite visualização na vertical ou horizontal. Níveis de alarmes ajustáveis da SpO2 e frequência cardíaca. Informações: memória interna permite armazenar 120 horas de dados de tendências Indicador luminoso de alerta, software permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos através da conexão USB (opcional), Alimentação bivolt automático, bateria interna recarregável com autonomia de 20 horas e carregador integrado ao equipamento, Gerenciamento de informações do paciente, incluindo nome, sexo e tipo Aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal, Dados técnicos: SpO2 : Intervalo: 0-100%, Precisão : ± 2% em 70-100%, Resolução: 1%, Pulsação : 30-250bpm, Precisão: ± 2bpm, Resolução: 1%.	Und	10	611,56	6.115,60



GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos


93

	Dimensões: 13,5 x 7,5 x 2,8 cm, Peso: 260 gramas. Acessórios inclusos: 01 Sensor de SpO2 reutilizável adulto, 04 baterias Ni-MH recarregáveis, 01capa de proteção com suporte, 01fonte de alimentação bivolt (100 a 240VAC), 01manual de operação.				
23	SENSOR DE OXIMETRIA CLIP ADULTO COMPATÍVEL COM MONITOR CHOICEMMED.	Und	1	640,00	640,00
24	SENSOR DE OXIMETRIA COMPATÍVEL C/ MONITOR OLIDEF. Descrição do Produto: Marca: YKD Maple, Sensor de Oximetria Adulto Compatível com (OLIDEF LOGICARE) Cabo com 3 metros de comprimento permite maior mobilidade, "dispensando a necessidade de um cabo extensor"; Modelo: CSL285B , Plug com 8 Pinos. Compatibilidade: (OLIDEF LOGICARE).	Und	2	1.599,00	3.198,00
					205.900,19
LOTE 04 - MATERIAIS/EQUIPAMENTOS					
1	Mesa Para Exames - estrutura confeccionada em aço carbono tubular; leito estofado em espuma densidade D 28, revestimento em courvim, montado sobre quadro com estrado em tubos de aço carbono; cabeceira regulável, tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó; com 2 gavetas em metal ou MDF sob o leito; Pés com ponteiros plásticos; Capacidade mínima: 150 kg; medidas aproximadas: Altura: 80,00 Centímetros, Largura: 60,00 Centímetros, Profundidade: 1,85 Metros	Und	15	1.980,00	29.700,00
2	APOIO /SUPORTE BRAÇADEIRA PARA COLETA DE EXAMES, altura ajustável de 74cm a 110cm.Estrutura em aço carbono e pintura eletrostática, Haste cromada, Pés niveladores, Apoio de mão com capa removível. Ficha técnica: Produto: apoio de braço com altura regulável, Composição: aço com pintura eletrostática branca. Altura mínima de 74 cm. Altura máxima de 110cm Medidas do apoio de braço: 19cm x 13cm Garantia fornecida pelo fabricante.	Und	5	180,00	900,00
3	CADEIRA PARA BANHO/HIGIENIZAÇÃO Cadeira de Banho Dobrável em Aço para 100 kg modelo D40 3X1 MULTIUSO Construída em aço carbono e pintura epóxi. Especificações: - Alta resistência a umidade (pintura epóxi); - Leve e prática; - Desmontável e dobrável; - Suporte para comadre; - Resistente; - Encosto em courino flexível; - Apoio de braços ergonômico em plástico; - Apoio de pés removível; - 04 rodízios giratórios de 4"; - Rodas dianteiras com freio; - Sistema de engate rápido pino click; - Armazenamento otimizado, ideal para uso em pequenos espaços; - Ocupa apenas 25% do espaço comparado às demais cadeiras de banho similares. LARGURA INTERNA 44 CM / LARGURA TOTAL 53 CM PESO MÁXIMO ATÉ 100 KG ROBUSTEZ - Estrutura em aço carbono e assento em plástico. GIRO DE 360° 3 EM 1 - Dobrável, desmontável e suporte para comadre. Composição: Estrutura desenvolvida em aço carbono com pintura epóxi resistente à ferrugem e assento em plástico.	Und	2	460,55	921,10
4	CARRO CARRINHO DE AÇO INOX COM 3 PRATELEIRAS. Serviço para Transporte 3 Bandejas 80x52 Inox 430 prateleiras lisaDescrição Ficha Técnica: Bandejas com bordas 4cm.- Rodízios Super-resistentes para facilitar o deslocamento.- Rodízios traseiros com travas. Tamanho da bandeja: 4cm A x 51cm L x 80cm	Und	1	1.440,00	1.440,00
5	CARRO DE CURATIVO HOSPITALAR EM AÇO INOX COM BALDE E BACIA - Acompanha balde em aço inox com tampa, capacidade de 10 litros e 20 cm de diâmetro.Acompanha bacia em aço inox de 30	Und	2	1.332,00	2.664,00



GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

	cm de diâmetro. Pés com rodízios giratórios de 50 mm (2") de diâmetro. Peso máximo suportado por prateleira: 20 Kg. Dimensões: Largura: 0,40 m x Altura: 0,88 m x Profundidade: 1,10 m				
6	Carro de Curativo: Armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios de 3", acompanha 01 balde 5 litros em alumínio polido e 01 bacia 3 litros inoxidável. Dimensões: 0,75m X 0,45m larg. X 0,80m altura.	Und	3	1.000,00	3.000,00
7	CARRO MACA PARA TRANSPORTE INOX, Leito Estofado com Grades, Leito fixo, estofado, compensado de 15 mm, com espuma Revestido em courvim. Cabeceira móvel. Grades laterais em tudo de aço inox de 1" x 1,25 mm. Pára-choque de borracha. Suporte para soro em inox Rodízios de 5" sendo dois com freios em diagonais. Acabamento em pintura epoxi. DIMENSÕES Peso (Gramas) 30000, Altura (cm) 80, Largura (cm) 60, Comprimento (cm) 200	Und	1	1.920,00	1.920,00
8	COLCHÃO PNEUMÁTICO COM MOTOR INCLUÍDO (ANTI ESCARAS)-220v COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: Colchão Inflável, fabricado de PVC0, 3mm; Mangueira de Conexão; Unidade de Controle, com compressor de alumínio; 220V, Kit para pequenos reparos; Registro ANVISA: 80795959001. Material de PVC; Dimensões: 198x89x6cm (comprimento, largura e altura inflado); Peso: 2,3kg; Durável e compacta; -Indicado para pacientes até 130kg;	Und	6	389,35	2.336,10
9	MACA GINECOLOGICA. MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA. Modelo standard armação e gaveta em pintura epóxi, leito fixo totalmente estofado em corino. Acompanha par de porta-coxa estofado com haste em aço zincado e suporte para balde em pintura epóxi. Assento fixo, encosto e peseira reguláveis. Capacidade Máxima: 120kg. Dimensões externas aproximadas: 1,82 m compr. x 51,5 cm largura x 0,89 cm alt.	Und	5	1.078,00	5.390,00
10	MACA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, EM AÇO PINTADO, COM GRADES DE PROTEÇÃO, CARRO MACA PADIOLA EPÓXI COM GRADES LEITO FIXO ESTOFADO, DESCRIÇÃO Confeccionado em tubos de 1.1/4 x 1,20 mm, rodízios, sendo 2 com freios em diagonal. Leito em madeira com espuma densidade 23, revestido em courvin fixo ao cavalete. Cabeceira regulável. Com grades laterais. Estrutura em pintura eletrostática pó após tratamento antiferruginoso. Capacidade: 150kg. Dimensões: 1.80m x 0,50m x 0,76m (CxLxA). Medidas da embalagem: 1,82 x 0,58 x 0,78 (CxLxA). Peso: 25kg.	Und	1	480,00	480,00
11	MACA. Estrutura: Confeccionada em tubos de aço de carbono de 1,20 mm, e os pés possuem ponteiros de borracha. Leito: É feito em madeira com espuma de 5 cm, revestida em courvin, e cabeceira possui regulagem de altura através de cremalheiras. Acabamento: Pintura eletrostática feito com pó e o interior sofre tratamento antiferruginoso.	Und	12	779,95	9.359,40
12	MESA AUXILIAR HOSPITALAR COM RODÍZIO 40X60, Mesa Auxiliar Inox c/ Rodas 40 x 60 x 80 cm, Especificação: Estrutura tubular em inox redondo, tampo e prateleira em chapa de aço, inox de alta resistencia, pés com rodízios de 2"	Und	4	800,00	3.200,00
13	MESA AUXILIAR PARA BISTURIS - AÇO INOXIDÁVEL Estrutura a prateleiras totalmente confeccionadas em aço inoxidável, com acabamento polido. Dotado de rodízios de 03" sistema duplo	Und	1	1.080,00	1.080,00




GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

	rodado, com freios em diagonal. Dimensões: L: 0,50 m x C: 0,66 m x A: 0,80 MARCA BK.				
14	Mesa Auxiliar: Epóxi com Ponteiras Pés tubulares 3/4 com ponteiras tampo e prateleira com pintura epóxi. Dimensões externas aproximadas 40 cm comp. x 40 cm larg. x 80 cm alt. Espessura da chapa 0,61 mm bitola 24. Cubagem: 0,128 M³ Peso: 4kg.	Und	10	270,00	2.700,00
15	MESA DE MAYO EM INOX, Armação tubular com rodízios de 2 totalmente de inox altura regulável por roseta. Acompanha bandeja em aço inox. Altura mínima 0,77m. Altura máxima 1,25m. Dimensões da bandeja: 43cm de comp. x 30,5 cm de larg. Medidas da embalagem 0,73 X 0,50 X 0,58. Cubagem: 0,2117m³, Peso: 3kg.	Und	3	522,00	1.566,00
16	SUPORTE DE SORO. Fabricado em tubo de aço carbono quadrado 25x25x1.20 mm, tubo de aço carbono 7/8x1.20 mm, tubo de aço carbono 5/8x1.20 mm, e mecânico maciço de 1/4. Acabamento com pintura eletrostática - prensa tubo para regulagem de altura e ponteiras de acabamento. Altura Máxima 2.15 metros , e altura mínima 1.85 metros.	Und	10	234,00	2.340,00
17	SUPORTE HAMPER INOX C/ TAMPA INOX C/ SACO EM SARJA CRU SUPORTE PARA SACO HAMPER INOX, Armação tubular em inox saco em forte tecido de algodão cru, pés com rodízios, Capacidade aproximada 150 litros. Dimensões aproximadas do saco: 0,50 cm de diâmetro x 0,80 cm de profUndidade. Dimensões externas aproximadas: Larg. 0,50 cm x Alt. 0,81 cm. Peso: 4kg.	Und	3	800,00	2.400,00
					71.396,60
LOTE 05 - MATERIAIS/EQUIPAMENTOS					
1	ARMÁRIO DE AÇO Especificação : Armário de Aço Fechado, com 02 portas, 04 prateleiras, acabamento em epóxi, anti-ferruginoso, tamanho 1,98 x 0,92 x 0,42 em cor cinza	Und	20	1.378,00	27.560,00
2	Armário Vitrine 2 Portas: Porta com fechadura cilíndrica fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi. Portas e laterais de vidro cristal de 3 mm e 4 prateleiras. Dimensões externas aproximadas 66 cm comp. x 40 cm prof. x 165 m de altura.	Und	20	1.260,00	25.200,00
3	Balde a Pedal - em aço inox, acionamento a pedal, capacidade 30 litros.	Und	10	432,10	4.321,00
4	Cadeira fixa em Polipropileno – especificação: estrutura em aço carbono, assento e encosto em Polipropileno azul; medidas aproximadas: Altura Total: 84cm ± 3cm, Profundidade Total: 53cm ± 3cm, Largura Total: 54cm ± 3cm, Largura Encosto: 46cm ± 1cm, Altura Encosto: 33cm ± 1cm, Largura Assento: 46cm ± 1cm, Profundidade Assento: 42cm ± 1cm.	Und	30	281,30	8.439,00
5	Cadeira giratoria- Modelo: Operativa Secretária; Material: Construída de assento, Constituída de assento, encosto, coluna a gás e base com rodízio. Assento consiste em uma estrutura de madeira. Com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 45 e 50 mm de altura e de forma levemente adaptada ao corpo. Modelo da Base: Base giratória, pistão modelo gás juntamente encaixado a base de cinco pernas com cinco rodízios.	Und	12	630,00	7.560,00
6	Escada de 02 de graus – estrutura em aço, piso antiderrapante, pés com ponteiras emborrachadas que não permitem deslizamento.	Und	6	126,00	756,00




GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

7	Longarina - especificação : com 03 lugares, armação de ferro, estrutura metálica tratada por antiferrugioso por fosfatização, pintada em epóxi pó, assento e encosto em prolipileno, na cor azul	Und	20	918,00	18.360,00
8	MESA AÇO INOX INDUSTRIAL / BANCADA DE APOIO - 2M (200X70X90CM), Mesa de 2m de comprimento, totalmente em aço inox, Suporta até 400kg de carga, sendo 300kg na tampa superior e 100kg na tampa inferior. resistente à corrosão, 100% Aço Inoxidável.	Und	1	960,00	960,00
9	Mesa para Computador: Especificação: revestida de melamínico, MDF, com duas gavetas com fechadura e chaves, na cor azul/cinza, dimensões mínimas : 1,20m x 0,62 x 0,75.	Und	15	197,00	2.955,00
10	Mesa para Consultório/Escritório (birô) Especificação: revestida de melamínico, MDP, com duas gavetas com fechadura e chaves, na cor azul/cinza, dimensões mínimas : 1,20m x 0,62 x 0,75.	Und	10	478,19	4.781,90
11	Mesa para Impressora - estrutura em aço carbono e tampo em madeira/mdp/mdf. Dimensões mínimas; altura: 70 cm, largura: 50 cm, profundidade: 40 cm.	Und	12	197,00	2.364,00
					103.256,90
LOTE 06 - MATERIAIS/EQUIPAMENTOS					
1	Balança Adulto. Modelo: 104 A. Capacidade: 300 kg; peso mínimo: 2kg; divisão: 100 gramas; tipo de balança: mecânica antropométrica; tamanho: adulto; estrutura: chapa de aço carbono; régua: aço cromado; perfil de escala numérica: alumínio; cursores: aço inoxidável; acabamento: tinta poliéster a pó; pés: reguláveis; material do pés: borracha sintética; antropômetro: alumínio anodizado e litografado; medida: até 2 metros; tapete: antiderrapante; medidas de base: 54 x 38 cm; homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM.	Und	10	2.196,10	21.961,00
2	BALANÇA HOSPITALAR BRANCA BIVOLT 200 KG BASE 40X40CM Conteúdo da embalagem: 1 Balança Antropométrica, Dimensões aproximadas 117 x 52 x 43 cm (A x L x C), PEso aproximado da embalagem: 14,2 Kg, Possui bandeja em aço carbono	Und	1	1.985,95	1.985,95
3	Balança Pediátrica. Capacidade: 15Kg; Carga Mínima: 100g; Divisão: 5g; Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm Injetada em material antigermes; Faixa de medição antropométrica na concha de 54 cm; Gabinete em Plástico ABS; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Estrutura interna em aço carbono bicromatizado c/ cobertura plástica; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte bivolt automático (90 a 240 VAC c/ chaveamento automático); Função TARA até capacidade máxima da balança; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; Dimensões aproximadas: 54 x 29cm.	Und	15	1.000,00	15.000,00
					38.946,95
LOTE 07 - MATERIAIS/EQUIPAMENTOS					
1	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL 15 LITROS, MATERIAL EM POLIETILENO, REVESTIMENTO INTERNO	Und	1	436,37	436,37
2	Caixa térmica com termômetro: externo digital. Dados da caixa: Produzida em material de alta resistência. Revestimento interno em poliuretano (PU) que auxilia no isolamento térmico. Tampa removível. Capacidade de, no mínimo, 15 litros. Alimentação do	Und	17	436,37	7.418,29



GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

	termômetro através de pilha.				
3	FILTRO HMEF ADULTO COM TRAQUEIA E TAMPA. Características: Dimensões: Altura 78,3mm; Ø 68,5mm, Material Meio Filtrante: Celulose & Polipropileno Hidrofóbico Eletrostático Estrutura: Polipropileno, Saída de Umidade: >31mg/H2O @ VT 500ml. Conexões: 22M-15F/22F-15M, Peso: 27g, Acesso a Monitorização Capnógrafo: Conexão Luer Lock fêmea com tampa Registro ANVISA 80158680013	Cx	5	20,00	100,00
4	FILTRO HMEF INFANTIL COM TRAQUEIA E TAMPA filtro conectado a um tubo traqueia colapsável com tampa. Feito de material descartável e translúcido, Evita infecção no circuito respiratório, entrada para capnógrafo com conector luer lock. O tubo traqueia possui conexão 15/22 mm e é extensível de 8 a 15 cm.	Cx	2	21,00	42,00
5	FILTRO MECÂNICO HEPA PLISSADO COM TRAQUEIA.	Cx	5	52,00	260,00
6	Fita Métrica 1,50 Metros. Fita métrica para Costureira, Alfaiate, Artesanato, Academia, Medição corporal, Fita métrica de 1,5m de comprimento, usado para varias finalidades.	Und	70	5,14	359,80
7	Kit com 24 ventosas – acompanha aplicador; tamanhos (Diâmetro interno): 4 unidades 2,6 cm, 4 unidades 3,6 cm, 4 unidades 4,2 cm, 4 unidades 5 cm, 4 unidades 5,8 cm e 4 unidades 6,2 cm; modelo: ventosa chinesa; material: acrílico.	Kit	2	246,58	493,16
8	LANTERNA CLINICA LED DIAGNOSTICO, Tampa Haste em Aço (Liga/Desliga), Cabo (Punho) em Alumínio Anodizado para 02 (duas) pilhas pequenas tamanho AAA (Tipo Palito), Cabeçote em Alumínio Anodizado, LED 3,0 Volts.	Und	3	150,00	450,00
9	LANTERNA CLINICA. LANTERNA CLÍNICA LED ESPECIFICAÇÃO: LANTERNA CLÍNICA LED - PARA EXAMES CLÍNICOS DE ROTINA.	Und	17	150,30	2.555,10
10	Regua Antropométrica Madeira Régua antropométrica pediátrica constituída em marfim, medindo 1 metro de comprimento e mandíbula retrátil, contendo marcação em milímetros, super prática e leve. Especificações: - Indicado para medir crianças; - Régua pediátrica; - Constituída em madeira marfim padrão; - 1 metro de comprimento.	Und	15	138,54	2.078,10
					14.192,82
LOTE 08 - MATERIAIS/EQUIPAMENTOS					
1	COMADRE HOSPITALAR INOX 2,5 LITROS, Coletor Urinário feminino, DIMENSÕES: Peso (Gramas) 850, Altura (cm) 8, Largura (cm) 26, Comprimento (cm) 42	Und	5	220,00	1.100,00
2	PAPAGAIO AÇO IXOXIDÁVEL HOSPITALAR 1000ML, Papagaio em aço inoxidável - Capacidade de 1000 ml.	Und	5	170,10	850,50
3	PINÇA ADSON DENTE DE RATO 16 CM, pinça Anatômica Dente de Rato 16cm, Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos- Embalagem: Plástica individual, Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação- Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. dimensões: Altura: 8 Centímetros, Largura: 19 Centímetros, ProfUndidade: 16 Centímetros Peso: 200 Gramas.	Und	2	61,45	122,90
4	PINÇA ADSON DENTE DE RATO 18 CM, Material confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável. Tamanho: 18cm, Garantia: 10 anos contra defeito de fabricação, Material: Aço Inox 304. Certificados: RDC 16/2013. ANVISA Registro MS: MS 80310620006.	Und	2	74,85	149,70




GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

5	PINÇA BACKAUS 10CM. Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, Marca ABC, Fabricante ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, Garantia 10 anos, Certificações Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS: 10304850059.	Und	6	45,50	273,00
6	PINÇA BACKAUS 14CM, Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, Fabricante BSZ INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, Garantia 10 anos, Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS: 10304850059.	Und	2	69,65	139,30
7	PINÇA CRILE CURVA, Medida: 14cm, em Aço Inoxidável AISI-420.	Und	2	41,80	83,60
8	PINÇA CRILE CURVA, Medida: 16cm, em Aço Inoxidável AISI-420.	Und	5	49,55	247,75
9	PINÇA CRILLE RETA, Medida: 14cm, Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420.	Und	3	41,80	125,40
10	PINÇA FAURE COM DENTE 20 CM, Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos. Utilizado em procedimentos Ginecológicos.	Und	2	112,00	224,00
11	PINÇA FAURE COM DENTE 22 CM REG. MS:10304850055. Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.	Und	2	84,80	169,60
12	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 10 CM, Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos- Embalagem: Plástica individual, GARANTIA: 10 anos contra defeitos de fabricação - Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Dimensões: Altura: 10 Centímetros, Largura: 5 Centímetros, ProfUndidade: 10 Centímetros, peso: 200 Gramas.	Und	4	40,80	163,20
13	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12 CM, Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos- Embalagem: Plástica individual, Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação- Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Dimensões: Altura: 10 Centímetros, Largura: 5 Centímetros, ProfUndidade: 13 Centímetros, Peso: 200 Gramas.	Und	4	36,70	146,80
14	PINÇA KELLY CURVA 14CM, Pinça Kelly Curva 14 cm utilizada para hemostasia. hastes arredondadas, Produzido em aço inoxidável com tratamento contra oxidação. Instrumental cirúrgico padrão, Garantia: 10 anos.	Und	4	41,80	167,20
15	PINÇA KELLY CURVA 16CM, produto confeccionado em aço inoxidável cirúrgicos.	Und	2	49,55	99,10
16	PINÇA KELLY RETA 14CM, reg. ms: 10304850055, Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos, Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação, Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da abnt, ce.	Und	2	41,80	83,60
17	PINÇA KELLY RETA 16CM, pinça kelly reta 16CM, Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, Tamanho: 16CM, Embalagem: Plástica individual, Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação, Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da abnt, ce.	Und	2	49,55	99,10
18	PINÇA KOCHER RETA 16CM, Instrumental com qualidade, Produzido em aço inoxidável, produto com 10 anos de garantia. Modelo: Pinça Kocher Reta, Tamanho: 16 cm, Registro ANVISA: 80310620005.	Und	2	59,30	118,60
19	PORTA AGULHA PARA FIO DE AÇO 14CM, REG. MS: 10304850055.	Und	2	36,90	73,80



GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

	Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico. Embalagem: Plástica individual, Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.				
20	SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE DESCARPACK, 13 LITROS - Suporte de metal para coletor perfurocortante 13L - Descarpack, Especificações: Material: arame BTC na cor branca. Possui parafusos e buchas para fixação na parede.	Und	10	67,28	672,80
21	TESOURA MAYO RETA 16CM, Tesoura Mayo Reta 16cm, Produzido em aço inoxidável com tratamento contra oxidação	Und	4	50,55	202,20
22	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14 CM, tesoura cirúrgica, Ponta Romba, em aço inoxidável. Autoclavável. Dimensão:- Comprimento - 140 mm- Espessura da ponta ativa - 1,0 mm- Largura da ponta ativa - de 0,8 mm á 8,0 mm.	Und	2	55,25	110,50
23	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18 CM, Ponta Curva, Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico. AISI-420, Certificações Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS: 10304850059.	Und	2	66,00	132,00
					5.554,65,



GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS


Ao Município de Farias Brito, Estado do Ceará.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os do Decreto nº 10.024/2019 e das Leis nº 10.520/2002 e 8.666/1993, bem como às cláusulas e condições da modalidade **Pregão Eletrônico nº 2022.02.24.1.**

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens especificados no Anexo I, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação.


Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Farias Brito/CE, conforme especificações apresentadas abaixo.

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
LOTE 01 - MATERIAIS/EQUIPAMENTOS						
1	Computador - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 threads e frequência de 3.0 GHz; possuir 1 disco rígido de 1 TB ou SSD 240 GB, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org , organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB de memória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9). Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir graduações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão	Und	25			




GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

2	<p>Computador (Desktop - Básico) - especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel Core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabytes; memória Ram de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX, ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT OU DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD,DVD rom; teclado USB, Abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, Scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) interfaces de rede 10/100/1000 e Wi fi padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir graduações neutra das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.</p>	Und	25			
3	<p>Impressora Laser - especificações mínimas: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/1000 ethernet e WiFi 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.</p>	Und	5			
4	<p>Notebook - especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador</p>	Und	1			



GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos


	portátil (notebook) com processador no mínimo Intel Core i5 ou AMD a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 GIGABYTES velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD Rom; memória RAM de 8 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior, tela LCD de 14 ou 15 Polegadas Widescreen, suportar resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão UBS e botão de rolagem (scroll); interface de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11 ^a a/b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); bateria recarregável do tipo ion de lítio com no mínimo 06 (seis) células; fontes externas automática compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port 01 (uma) VGA, leitor de cartão; webcam FULL HD (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.					
Total:						
LOTE 02 - MATERIAIS/EQUIPAMENTOS						
1	Ar condicionador 12.000 btus - especificação: condicionado slip, inverter, quente e frio, branco, características baixo ruído, controle remoto, desumidificação, filtro antivírus, função sleep, selo procel, classe A, compressor, consumo [kw/h] 17,01. vazão de ar 500,timer, filtro de proteção ativa, direcionadores de ar saída regulável do ar, painel eletrônico, controle de temperatura, voltagem 220v/110v, conteúdo da embalagem: unidade evaporada, 1 controle remoto, dimensões aproximadas do produto - cm [axl xp] 26,2x79x19,5cm, garantia do fornecedor.	Und	12			
2	Ar condicionador 9.000 btus - especificação: condicionado slip, inverter, quente e frio, branco, características baixo ruído, controle remoto, desumidificação, filtro antivírus, função sleep, selo procel, classe A, compressor, consumo [kw/h] .timer, filtro de proteção ativa, direcionadores de ar saída regulável do ar, painel eletrônico, controle de temperatura, voltagem 220v/110v, conteúdo da embalagem: unidade evaporada, 1 controle remoto, garantia do fornecedor.	Und	6			
3	TV. tamanho de tela: 32 polegadas. Resolução: HD (1366 x 768p) Sistema Operacional: Saphi.	Und	10			



GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO


Uma Farias Brito para todos

	Frequência: 60 Hz. Potência de áudio: 10 Watts RMS. Conectividade: HDMI (2x), USB (2x) e Wi-Fi.					
4	GELADEIRA - Refrigerador doméstico com capacidade mínima de 275 litros - , Capacidade mínima do refrigerador 215 lt, e capacidade mínima do freezer de 60 lt, cor branca, Contendo: porta ovos, controle de temperatura, pés reguláveis, bivolt. Eficiência de energia: tipo A.	Und	12			
5	Bebedouro de Coluna Geláguas - especificação: dimensões aproximadas do produto: 220v altura: 1.01 m largura: 32.00 cm profundidade: 32.00 cm profundidade: 32.00 cm, cor branco, tipo de água: garrafão, material de plásticos e aço, com 02 torneiras, bandeja de água removível.	Und	10			
6	VENTILADOR. Fonte de alimentação: energia elétrica; número de velocidades: 3; número de lâminas: 6; Tensão: 220 volts; comprimento de lâmina: 47 centímetros	Und	10			
Total:						
LOTE 03 - MATERIAIS/EQUIPAMENTOS						
1	ANALISADOR DE IONS/ ELETROLITOS BIOCLIN IONS K+, NA+, CL-, CA2+, PH - R10050	Und	1			
2	ANALISADOR DE URINA URIVISION 100 - WAMA - CÓD 01871	Und	1			
3	ANALISADOR IMUNOLOGICO FINECARE FIA METER PLUS CELER - CÓD. 02995	Und	1			
4	APARELHO PARA HEMOSSEDIMENTACAO VHS TIMER - MARCA CLOT	Und	1			
5	ASPIRADOR CIRÚRGICO 6L COM FRASCOS AUTOCLAVÁVEL MD600, Tensão 127/220V Bivolt automático, 60 Hz, Fusível 3A, Capacidade do frasco coletor 3,0 litros cada frasco. Dimensão do aparelho C: 450 x L: 485 x A: 1040 mm, Potência nominal total 200W ou aprox. 1/4 CV +/- 8%, Proteção térmica Sim. Tipo de proteção contra choque elétrico Aspirador de classe /Pedal classe II	Und	4			
6	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLIO ESMALTADO, Estrutura tubular em aço redondo;- Cortinas em plástico pvc 0,20 branco, Pés com rodízios giratório de 2" de diâmetro, Dimensões: 1,82m largura aberto x 0,66m largura fechado x 1,77m altura x 0,50m comprimento;Peso: 10 KG.	Und	4			
7	BISTURI ELÉTRICO HF-120 Características: 6 funções: corte puro, blend 1, blend 2, blend 3, coagulação e bipolar. Display digital que indica potências. Memória não volátil, Sistema de monitoramento de circuito com alarme e reconhecimento automático de placa-paciente comum ou bipartida. Produto certificado de acordo com a norma NBRIEC 60601-2-2, incluindo teste de interferência eletromagnética (EMC) - Classe CF Dimensões: 15 cm (A) x 24,5 cm (L) x 26 cm (P), Peso: 3,5 Kg, Registro Anvisa:N.º:	Und	1			




GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

	10247670035, Alimentação: 127 / 220 VAC - 50/60 hz					
8	CENTRIFUGA LABORATORIAL - Microprocessada Digital 24 Tubos 10ml	Und	1			
9	COAGULOMETRO MAX COAG 1 CANAL C/ PIPETADOR	Und	1			
10	DESTILADOR DE AGUA CRISTÓFOLI, Destilador de água Cristófoli · Desenvolvido para destilar água para uso em autoclaves de esterilização a vapor, Capacidade: 4 litros, Dimensões: 27 x 33 x 27,6 cm (L x A x P), Voltagem: 127 V ou 220 V. Frequência: 50/60 Hz Alimentação Elétrica, Registro ANVISA, Capacidade do Reservatório - Água Destilada 3,8L, Reservatório - Água Comum 4 L Tempo de Ciclo Aproximado 6 - 8 horas	Und	1			
11	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL - sensibilidade a partir de 10-12 semanas; transdutor de alta sensibilidade; alto-falante de alta performance; entrada para fone de ouvido, gravador de som ou computador; botão liga/desliga e controle de volume e desligamento automático; tela de lcd com indicador de batimento cardíaco fetal e bateria fraca no display, bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento (bivolt); dimensões aproximadas: 33mm x 117mm x 131 mm, performance fhr: faixa de medição: 50-240 bpm; resolução: 1bpm; precisão: ± 1 bpm; saída de energia: 20mw. transdutor: frequência nominal: 2.0mhz; frequência de operação: 2.0mhz ± 10%; p-: <1mpa; lob: <20 mw/cm²; ispta: <100 mw/cm², intensidade de saída de ultrassom: isata <10 mw/cm²; área de radiação efetiva do transdutor: 154mm², garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.	Und	14			
12	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL FD200B Transdutor de alta sensibilidade. Design ergonômico e compartimento para transdutor. Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador. Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal. Alimentação através de pilhas alcalinas. Certificado pelo INMETRO.	Und	2			
13	Eletrocardiógrafo digital de 12 canais e 12 derivações simultâneas CARDIOCARE 2000 - Laudo interpretativo, Impressão em papel termo-sensível milimetrado, papel comum A4, Velocidade de avanço do papel ajustável entre 25mm/seg e 50mm/seg, operação em modo manual e modo automático, Aquisição das 12 derivações, Display com visor de cristal líquido digital, Proteção contra descarga de desfibriladores, Atualização do software pela internet gratuitamente	Und	1			
14	FOCO CIRÚRGICO DE SOLO MÓVEL, LED95220 V / 50 HZ, Foco Cirúrgico Auxiliar LED,	Und	1			




GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

	Equipamentos projetados e montados seguindo normas nacionais e internacionais de segurança elétrica e gerenciamento de riscos, Possui haste giratória, Rodízios em material resistente, aço tratado com banho antioxidante e antiferrugem. Pintados em epóxi a 250° Célcius com acabamento em poliestireno de alto impacto. Sistema de iluminação com LED, iluminância é de 31.000 lux a 75 cm e 24.000 lux a 100 cm de distância, ajuste fixo com diâmetro de foco correspondente a: "d50=100 mm". Vida útil mínima esperada para os LED'S de 35.000 horas e média de 50.000 horas. Normas: NBR IEC 60601-1 e ABNT NBR IEC 60601-1-2., selo do INMETRO. Manopla removível e autoclavável.					
15	FOCO PARA PREVENÇÃO. Composição de aço carbono, leve (2,4 kg) e de alta durabilidade porque não enferruja. Haste flexível para melhor direcionamento da lâmpada. Altura regulável de 110 a 135 cm. Acompanha lâmpada Led fria e branca 6w bivolt. Base com rodinhas para facilitar locomoção.	Und	10			
16	KIT GPAP AIRSENSE 10 + UMIDIFICADOR RESMED + MÁSCARA YUWELL ORONASAL VIEW ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, Uso Adulto, Diâmetro da válvula: cotovelo de 22mm, Quadro central, válvula/cotovelo e cliques em policarbonato e polipropileno. Almofada em silicone, DIMENSÕES DA MÁSCARA: Tamanho P e M.	Und	1			
17	KIT VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXOMETRO OXIGÊNIO, Escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 Mpa (0 à 315 Kgf/cm²). Conexões de entrada e saída: Latão cromado, Manômetro: Aço com pintura epóxi. - Conexões de entrada e saída, conforme as normas ABNT.	Und	5			
18	MICROSCOPIO LABORATORIAL.	Und	1			
19	MONITOR MULTIPARÂMETROS INMAX 12" BÁSICO INSTRAMED. Cód. Ref.7547, acesso simples e rápido, observar as frequências cardíacas, garantia da marca Instramed.	Und	1			
20	NEGATOSCOPIO. Negatoscópio De 01 Corpo, Modelo Simples- Destinados A Simples Visualização Ou Para Fins De Diagnóstico De Imagens Analógicas Ou Digitais; Construído Em Chapa De Aço; Pintado Eletrostaticamente Nas Cores Cinza, Branco, Bege Ou Preto; Parte Frontal Em Acrílico Translúcido Branco Leitoso; Iluminação Através De Duas Lâmpadas Fluorescentes De 15W 6500K Por Corpo; Acionamento Por Reatores Eletrônicos De Alto Fator De Potência; Luminância Aproximada De 2000 Nits; Acendimento Através De Interruptor; Disponível Em 110V ou 220V; Dimensões Externas: 380X100X485Mm; Dimensões Área De Leitura: 360X410Mm;	Und	5			




GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

	Grupo:Padrão;Altura:485; Largura:100 mm; Comprimento:380 mm					
21	Otoscópio Simples - iluminação branca e de alto brilho; possibilita avaliar a mobilidade da membrana timpânica; reostato para controle de intensidade da luz; não contém látex; transmissão da luz direta; lâmpada: vácuo, halógena ou led; material da cabeça: metal; material do cabo em metal; acabamento do cabo recartilhado; tensão 2.5v; alimentação: 2 pilhas tipo c; lente de aumento 4 vezes; acompanham o produto: 05 espéculos auriculares autoclaváveis (2.5, 3.5, 4.5, 5.5 e 9mm) 01 estojo macio para otoscópio e seus acessórios; garantia do equipamento: 1 ano.	Und	17			
22	Oxímetro de Pulso Portátil de Mão - tela com LCD colorido de alta resolução, indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabelas de tendência. Aparelho portátil e leve, com baterias e sensor. Tela rotacional, permite visualização na vertical ou horizontal. Níveis de alarmes ajustáveis da SpO2 e frequência cardíaca. Informações: memória interna permite armazenar 120 horas de dados de tendências Indicador luminoso de alerta, software permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos através da conexão USB (opcional). Alimentação bivolt automático, bateria interna recarregável com autonomia de 20 horas e carregador integrado ao equipamento, Gerenciamento de informações do paciente, incluindo nome, sexo e tipo Aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal, Dados técnicos: SpO2 : Intervalo: 0-100%, Precisão : ± 2% em 70-100%, Resolução: 1%, Pulsação : 30-250bpm, Precisão: ± 2bpm, Resolução: 1%. Dimensões: 13,5 x 7,5 x 2,8 cm, Peso: 260 gramas. Acessórios inclusos: 01 Sensor de SpO2 reutilizável adulto, 04 baterias Ni-MH recarregáveis, 01capa de proteção com suporte, 01fonte de alimentação bivolt (100 a 240VAC), 01manual de operação.	Und	10			
23	SENSOR DE OXIMETRIA CLIP ADULTO COMPATÍVEL COM MONITOR CHOICEMMED.	Und	1			
24	SENSOR DE OXIMETRIA COMPATÍVEL C/ MONITOR OLIDEF. Descrição do Produto: Marca: YKD Maple, Sensor de Oximetria Adulto Compatível com (OLIDEF LOGICARE) Cabo com 3 metros de comprimento permite maior mobilidade, "dispensando a necessidade de um cabo extensor"; Modelo: CSL285B , Plug com 8 Pinos. Compatibilidade: (OLIDEF LOGICARE).	Und	2			
Total:						
LOTE 04 - MATERIAIS/EQUIPAMENTOS						
1	Mesa Para Exames - estrutura confeccionada em	Und	15			



GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

	aço carbono tubular; leito estofado em espuma densidade D 28, revestimento em courvim, montado sobre quadro com estrado em tubos de aço carbono; cabeceira regulável, tratamento anti-ferruginoso, pintura eletrostática à pó; com 2 gavetas em metal ou MDF sob o leito; Pés com ponteiros plásticos; Capacidade mínima: 150 kg; medidas aproximadas: Altura: 80,00 Centímetros, Largura: 60,00 Centímetros, Profundidade: 1,85 Metros				
2	APOIO /SUPORTE BRAÇADEIRA PARA COLETA DE EXAMES, altura ajustável de 74cm a 110cm.Estrutura em aço carbono e pintura eletrostática, Haste cromada, Pés niveladores, Apoio de mão com capa removível. Ficha técnica: Produto: apoio de braço com altura regulável, Composição: aço com pintura eletrostática branca. Altura mínima de 74 cm. Altura máxima de 110cm Medidas do apoio de braço: 19cm x 13cm Garantia fornecida pelo fabricante.	Und	5		
3	CADEIRA PARA BANHO/HIGIENIZAÇÃO Cadeira de Banho Dobrável em Aço para 100 kg modelo D40 3X1 MULTIUSO Construída em aço carbono e pintura epóxi. Especificações: - Alta resistência a umidade (pintura epóxi); - Leve e prática; - Desmontável e dobrável; - Suporte para comadre; - Resistente; - Encosto em courino flexível; - Apoio de braços ergonômico em plástico; - Apoio de pés removível; - 04 rodízios giratórios de 4"; - Rodas dianteiras com freio; - Sistema de engate rápido pino click; - Armazenamento otimizado, ideal para uso em pequenos espaços; - Ocupa apenas 25% do espaço comparado às demais cadeiras de banho similares. LARGURA INTERNA 44 CM / LARGURA TOTAL 53 CM PESO MÁXIMO ATÉ 100 KG ROBUSTEZ - Estrutura em aço carbono e assento em plástico. GIRO DE 360° 3 EM 1 - Dobrável, desmontável e suporte para comadre. Composição: Estrutura desenvolvida em aço carbono com pintura epóxi resistente à ferrugem e assento em plástico.	Und	2		
4	CARRO CARRINHO DE AÇO INOX COM 3 PRATELEIRAS. Serviço para Transporte 3 Bandejas 80x52 Inox 430 prateleiras lisaDescrição Ficha Técnica: Bandejas com bordas 4cm.- Rodízios Super-resistentes para facilitar o deslocamento.- Rodízios traseiros com travas. Tamanho da bandeja: 4cm A x 51cm L x 80cm	Und	1		
5	CARRO DE CURATIVO HOSPITALAR EM AÇO INOX COM BALDE E BACIA - Acompanha balde em aço inox com tampa, capacidade de 10 litros e 20 cm de diâmetro.Acompanha bacia em aço inox de 30 cm de diâmetro. Pés com rodízios giratórios de 50 mm (2") de diametro.Peso máximo suportado por	Und	2		




GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

	prateleira: 20 Kg.Dimensões: Largura: 0,40 m x Altura: 0,88 m x ProfUndidade: 1,10 m				
6	Carro de Curativo: Armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios de 3", acompanha 01 balde 5 litros em alumínio polido e 01 bacia 3 litros inoxidável. Dimensões: 0,75m X 0,45m larg. X 0,80m altura.	Und	3		
7	CARRO MACA PARA TRANSPORTE INOX, Leito Estofado com Grades, Leito fixo, estofado, compensado de 15 mm, com espuma Revestido em courvim. Cabeceira móvel. Grades laterais em tudo de aço inox de 1" x 1,25 mm. Pára-choque de borracha. Suporte para soro em inox Rodízios de 5" sendo dois com freios em diagonais. Acabamento em pintura epoxi. DIMENSÕES Peso (Gramas) 30000, Altura (cm) 80, Largura (cm) 60, Comprimento (cm) 200	Und	1		
8	COLCHÃO PNEUMÁTICO COM MOTOR INCLUÍDO (ANTI ESCARAS)-220v COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: Colchão Inflável, fabricado de PVC, 3mm; Mangueira de Conexão; Unidade de Controle, com compressor de alumínio; 220V, Kit para pequenos reparos; Registro ANVISA: 80795959001. Material de PVC; Dimensões: 198x89x8cm [comprimento, largura e altura inflado]; Peso: 2,3kg; Durável e compacta; - Indicado para pacientes até 130kg;	Und	6		
9	MACA GINECOLÓGICA. MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA. Modelo standard armação e gaveta em pintura epóxi, leito fixo totalmente estofado em corinó. Acompanha par de porta-coxa estofado com haste em aço zincado e suporte para balde em pintura epóxi. Assento fixo, encosto e peseira reguláveis. Capacidade Máxima: 120kg. Dimensões externas aproximadas: 1,82 m compr. x 51,5 cm largura x 0,89 cm alt.	Und	5		
10	MACA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, EM AÇO PINTADO, COM GRADES DE PROTEÇÃO, CARRO MACA PADIOLA EPÓXI COM GRADES LEITO FIXO ESTOFADO, DESCRIÇÃO Confeccionado em tubos de 1.1/4 x 1,20 mm, rodízios, sendo 2 com freios em diagonal. Leito em madeira com espuma densidade 23, revestido em courvin fixo ao cavalete. Cabeceira regulável. Com grades laterais. Estrutura em pintura eletrostática pó após tratamento antiferruginoso. Capacidade: 150kg. Dimensões: 1.80m x 0,50m x 0,76m (CxLxA). Medidas da embalagem: 1,82 x 0,58 x 0,78 (CxLxA). Peso: 25kg.	Und	1		
11	MACA. Estrutura: Confeccionada em tubos de aço de carbono de 1,20 mm, e os pés possuem ponteiros de borracha. Leito: É feito em madeira com espuma de 5 cm, revestida em courvin, e	Und	12		




GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

	cabeceira possui regulagem de altura através de cremalheiras. Acabamento: Pintura eletrostática feito com pó e o interior sofre tratamento antiferruginoso.					
12	MESA AUXILIAR HOSPITALAR COM RODÍZIO 40X60, Mesa Auxiliar Inox c/ Rodas 40 x 60 x 80 cm, Especificação: Estrutura tubular em inox redondo, tampo e prateleira em chapa de aço, inox de alta resistencia, pés com rodízios de 2"	Und	4			
13	MESA AUXILIAR PARA BISTURIS - AÇO INOXIDÁVEL Estrutura a prateleiras totalmente confeccionadas em aço inoxidável, com acabamento polido. Dotado de rodízios de 03" sistema duplo rodado, com freios em diagonal. Dimensões: L: 0,50 m x C: 0,66 m x A: 0,80 MARCA BK.	Und	1			
14	Mesa Auxiliar: Epóxi com Ponteiros Pés tubulares 3/4 com ponteiros tampo e prateleira com pintura epóxi. Dimensões externas aproximadas 40 cm comp. x 40 cm larg. x 80 cm alt. Espessura da chapa 0,61 mm bitola 24. Cubagem: 0,128 M ³ Peso: 4kg.	Und	10			
15	MESA DE MAYO EM INOX, Armação tubular com rodízios de 2 totalmente de inox altura regulável por roseta. Acompanha bandeja em aço inox. Altura mínima 0,77m. Altura máxima 1,25m. Dimensões da bandeja: 43cm de comp. x 30,5 cm de larg. Medidas da embalagem 0,73 X 0,50 X 0,58. Cubagem: 0,2117m ³ , Peso: 3kg.	Und	3			
16	SUPORTE DE SORO. Fabricado em tubo de aço carbono quadrado 25x25x1.20 mm, tubo de aço carbono 7/8x1.20 mm, tubo de aço carbono 5/8x1.20 mm, e mecânico maciço de 1/4. Acabamento com pintura eletrostática - prensa tubo para regulagem de altura e ponteiros de acabamento. Altura Máxima 2.15 metros , e altura mínima 1.85 metros.	Und	10			
17	SUPORTE HAMPER INOX C/ TAMPA INOX C/ SACO EM SARJA CRU SUPORTE PARA SACO HAMPER INOX, Armação tubular em inox saco em forte tecido de algodão cru, pés com rodízios, CAPacidade aproximada 150 litros. Dimensões aproximadas do saco: 0,50 cm de diâmetro x 0,80 cm de profUndidade. Dimensões externas aproximadas: Larg. 0,50 cm x Alt. 0,81 cm. Peso: 4kg.	Und	3			
Total:						
LOTE 05 - MATERIAIS/EQUIPAMENTOS						
1	ARMÁRIO DE AÇO Especificação : Armário de Aço Fechado, com 02 portas, 04 prateleiras, acabamento em epóxi, anti-ferruginoso, tamanho 1,98 x 0,92 x 0,42 em cor cinza	Und	20			
2	Armário Vitrine 2 Portas: Porta com fechadura cilíndrica fundo e teto em chapa de aço em pintura	Und	20			



GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

	epóxi. Portas e laterais de vidro cristal de 3 mm e 4 prateleiras. Dimensões externas aproximadas 66 cm comp. x 40 cm prof. x 165 m de altura.					
3	Balde a Pedal - em aço inox, acionamento a pedal, capacidade 30 litros.	Und	10			
4	Cadeira fixa em Polipropileno - especificação: estrutura em aço carbono, assento e encosto em Polipropileno azul; medidas aproximadas: Altura Total: 84cm ± 3cm, Profundidade Total: 53cm ± 3cm, Largura Total: 54cm ± 3cm, Largura Encosto: 46cm ± 1cm, Altura Encosto: 33cm ± 1cm, Largura Assento: 46cm ± 1cm, Profundidade Assento: 42cm ± 1cm.	Und	30			
5	Cadeira giratoria- Modelo: Operativa Secretária; Material: Construída de assento, Constituída de assento, encosto, coluna a gás e base com rodízio. Assento consiste em uma estrutura de madeira. Com cantos arredondados e espuma injetada com densidade de 45 e 50 mm de altura e de forma levemente adaptada ao corpo. Modelo da Base: Base giratória, pistão modelo gás juntamente encaixado a base de cinco pernas com cinco rodízios.	Und	12			
6	Escada de 02 de graus - estrutura em aço, piso antiderrapante, pés com ponteiros emborrachadas que não permitem deslizamento.	Und	6			
7	Longarina - especificação : com 03 lugares, armação de ferro, estrutura metálica tratada por antiferrugioso por fosfatização, pintada em epóxi pó, assento e encosto em prolipropileno, na cor azul	Und	20			
8	MESA AÇO INOX INDUSTRIAL / BANCADA DE APOIO - 2M (200X70X90CM), Mesa de 2m de comprimento, totalmente em aço inox, Suporta até 400kg de carga, sendo 300kg na tampa superior e 100kg na tampa inferior. resistente à corrosão, 100% Aço Inoxidável.	Und	1			
9	Mesa para Computador: Especificação: revestida de melamínico, MDF, com duas gavetas com fechadura e chaves, na cor azul/cinza, dimensões mínimas : 1,20m x 0,62 x 0,75.	Und	15			
10	Mesa para Consultório/Escritório (birô) Especificação: revestida de melamínico, MDP, com duas gavetas com fechadura e chaves, na cor azul/cinza, dimensões mínimas : 1,20m x 0,62 x 0,75.	Und	10			
11	Mesa para Impressora - estrutura em aço carbono e tampo em madeira/mdp/mdf. Dimensões mínimas; altura: 70 cm, largura: 50 cm, profundidade: 40 cm.	Und	12			
Total:						
LOTE 06 - MATERIAIS/EQUIPAMENTOS						
1	Balança Adulto. Modelo: 104 A. Capacidade: 300 kg; peso mínimo: 2kg; divisão: 100 gramas; tipo	Und	10			



GÓVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO

Uma Farias Brito para todos


	de balança: mecânica antropométrica; tamanho: adulto; estrutura: chapa de aço carbono; régua: aço cromado; perfil de escala numérica: alumínio; cursores: aço inoxidável; acabamento: tinta poliéster a pó; pés: reguláveis; material do pés: borracha sintética; antropômetro: alumínio anodizado e litografado; medida: até 2 metros; tapete: antiderrapante; medidas de base: 54 x 38 cm; homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM.					
2	BALANÇA HOSPITALAR BRANCA BIVOLT 200 KG BASE 40X40CM Conteúdo da embalagem: 1 Balança Antropométrica, Dimensões aproximadas 117 x 52 x 43 cm (A x L x C), PEso aproximado da embalagem: 14,2 Kg, Possui bandeja em aço carbono	Und	1			
3	Balança Pediátrica. Capacidade: 15Kg; Carga Mínima: 100g; Divisão: 5g; Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material antigermes; Faixa de medição antropométrica na concha de 54 cm; Gabinete em Plástico ABS; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Estrutura interna em aço carbono bicromatizado c/ cobertura plástica; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte bivolt automático (90 a 240 VAC c/ chaveamento automático); Função TARA até capacidade máxima da balança; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; Dimensões aproximadas: 54 x 29cm.	Und	15			
Total:						
LOTE 07 - MATERIAIS/EQUIPAMENTOS						
1	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO DIGITAL 15 LITROS, MATERIAL EM POLIETILENO, REVESTIMENTO INTERNO	Und	1			
2	Caixa térmica com termômetro: externo digital. Dados da caixa: Produzida em material de alta resistência. Revestimento interno em poliuretano (PU) que auxilia no isolamento térmico. Tampa removível. Capacidade de, no mínimo, 15 litros. Alimentação do termômetro através de pilha.	Und	17			
3	FILTRO HMEF ADULTO COM TRAQUEIA E TAMPA. CaracterísticasDimensões: Altura 78.3mm; Ø 68.5mm, Material Meio Filtrante: Celulose & Polipropileno Hidrofóbico EletrostáticoEstrutura: Polipropileno, Saída de Umidade: >31mg/ H2O @ VT 500ml. Conexões: 22M-15F/22F-15M, Peso: 27g, Acesso a Monitorização Capnógrafo: Conexão Luer Lock fêmea com tampaRegistro ANVISA 80158680013	Cx	5			
4	FILTRO HMEF INFANTIL COM TRAQUEIA E TAMPA filtro conectado a um tubo traqueia colapsável com tampa. Feito de material descartável e translúcido, Evita infecção no circuito respiratório, entrada para	Cx	2			



GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos


	capnógrafo com conector luer lock. O tubo traqueia possui conexão 15/22 mm e é extensível de 8 a 15 cm.					
5	FILTRO MECÂNICO HEPA PLISSADO COM TRAQUEIA.	Cx	5			
6	Fita Métrica 1,50 Metros. Fita métrica para Costureira, Alfaiate, Artesanato, Academia, Medição corporal, Fita métrica de 1,5m de comprimento, usado para varias finalidades.	Und	70			
7	Kit com 24 ventosas - acompanha aplicador; tamanhos (Diâmetro interno): 4 unidades 2,6 cm, 4 unidades 3,6 cm, 4 unidades 4,2 cm, 4 unidades 5 cm, 4 unidades 5,8 cm e 4 unidades 6,2 cm; modelo: ventosa chinesa; material: acrílico.	Kit	2			
8	LANTERNA CLINICA LED DIAGNOSTICO, Tampa Haste em Aço (Liga/Desliga), Cabo (Punho) em Alumínio Anodizado para 02 (duas) pilhas pequenas tamanho AAA (Tipo Palito), Cabecote em Alumínio Anodizado, LED 3,0 Volts.	Und	3			
9	LANTERNA CLINICA. LANTERNA CLÍNICA LED ESPECIFICAÇÃO: LANTERNA CLÍNICA LED - PARA EXAMES CLÍNICOS DE ROTINA.	Und	17			
10	Regua Antropométrica Madeira Régua antropométrica pediátrica constituída em marfim, medindo 1 metro de comprimento e mandíbula retrátil, contendo marcação em milímetros, super prática e leve. Especificações: - Indicado para medir crianças; - Régua pediátrica; - Constituída em madeira marfim padrão; - 1 metro de comprimento.	Und	15			
Total:						
LOTE 08 - MATERIAIS/EQUIPAMENTOS						
1	COMADRE HOSPITALAR INOX 2,5 LITROS, Coletor Urinário feminino, DIMENSÕES: Peso (Gramas) 850, Altura (cm) 8, Largura (cm) 26, Comprimento (cm) 42	Und	5			
2	PAPAGAIO AÇO IXOXIDÁVEL HOSPITALAR 1000ML, Papagaio em aço inoxidável - Capacidade de 1000 ml.	Und	5			
3	PINÇA ADSON DENTE DE RATO 16 CM, pinça Anatômica Dente de Rato 16cm, Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos- Embalagem: Plástica individual, Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação- Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE, dimensões: Altura: 8 Centímetros, Largura: 19 Centímetros, Profundidade: 16 Centímetros Peso: 200 Gramas.	Und	2			
4	PINÇA ADSON DENTE DE RATO 18 CM, Material confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável.Tamanho: 18cm, Garantia: 10 anos contra defeito de fabricação, Material: Aço Inox	Und	2			

Handwritten signature



GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

	304.Certificados: RDC 16/2013. ANVISA Registro MS: MS 80310620006.					
5	PINÇA BACKAUS 10CM. Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, Marca ABC, Fabricante ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, Garantia 10 anos, Certificações Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS: 10304850059.	Und	6			
6	PINÇA BACKAUS 14CM, Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, Fabricante BSZ INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, Garantia 10 anos, Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS: 10304850059.	Und	2			
7	PINÇA CRILE CURVA, Medida: 14cm, em Aço Inoxidável AISI-420.	Und	2			
8	PINÇA CRILE CURVA, Medida: 16cm, em Aço Inoxidável AISI-420.	Und	5			
9	PINÇA CRILLE RETA, Medida: 14cm, Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420.	Und	3			
10	PINÇA FAURE COM DENTE 20 CM, Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos. Utilizado em procedimentos Ginecológicos.	Und	2			
11	PINÇA FAURE COM DENTE 22 CM REG. MS:10304850055.Produo Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos.Garantia:10 anos contra defeitos de fabricação.Certificações:Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.	Und	2			
12	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 10 CM, Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos- Embalagem: Plástica individual, GARANTIA: 10 anos contra defeitos de fabricação - Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Dimensões: Altura: 10 Centímetros, Largura: 5 Centímetros, ProfUndidade: 10 Centímetros, peso: 200 Gramas.	Und	4			
13	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO RETA 12 CM, Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos- Embalagem: Plástica individual, Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação- Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. Dimensões: Altura: 10 Centímetros, Largura: 5 Centímetros, ProfUndidade: 13 Centímetros, Peso: 200 Gramas.	Und	4			
14	PINÇA KELLY CURVA 14CM, Pinça Kelly Curva 14 cm utilizada para hemostasia.hastes arredondadas, Produzido em aço inoxidável com tratamento contra oxidação. Instrumental cirúrgico padrão, Garantia: 10 anos.	Und	4			
15	PINÇA KELLY CURVA 16CM, produto confeccionado em aço inoxidável cirúrgicos.	Und	2			



GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

16	PINÇA KELLY RETA 14CM, reg. ms: 10304850055, Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos, Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação, Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da abnt, ce.	Und	2			
17	PINÇA KELLY RETA 16CM, pinça kelly reta 16CM, Produto Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, Tamanho: 16CM, Embalagem: Plástica individual, Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação, Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da abnt, ce.	Und	2			
18	PINÇA KOCHER RETA 16CM, Instrumental com qualidade, Produzido em aço inoxidável, produto com 10 anos de garantia. Modelo: Pinça Kocher Reta, Tamanho: 16 cm, Registro ANVISA: 80310620005.	Und	2			
19	PORTA AGULHA PARA FIO DE AÇO 14CM, REG. MS: 10304850055. Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico. Embalagem: Plástica individual, Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE.	Und	2			
20	SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE DESCARPACK, 13 LITROS - Suporte de metal para coletor perfurocortante 13L - Descarpac, Especificações: Material: arame BTC na cor branca. Possui parafusos e buchas para fixação na parede.	Und	10			
21	TESOURA MAYO RETA 16CM, Tesoura Mayo Reta 16cm, Produzido em aço inoxidável com tratamento contra oxidação	Und	4			
22	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14 CM, tesoura cirúrgica, Ponta Romba, em aço inoxidável. Autoclavável. Dimensão:- Comprimento - 140 mm- Espessura da ponta ativa - 1,0 mm- Largura da ponta ativa - de 0,8 mm á 8,0 mm.	Und	2			
23	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18 CM, Ponta Curva, Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgico. AISI-420, Certificações Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. REG. MS: 10304850059.	Und	2			
Total:						

Valor Total da Proposta: R\$
(.....)

Proponente:



GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

Endereço:

CNPJ:

Data da Abertura:

Horário de Abertura:


Prazo de Entrega: Conforme Edital e Contrato.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

Data:

.....

Assinatura do Proponente

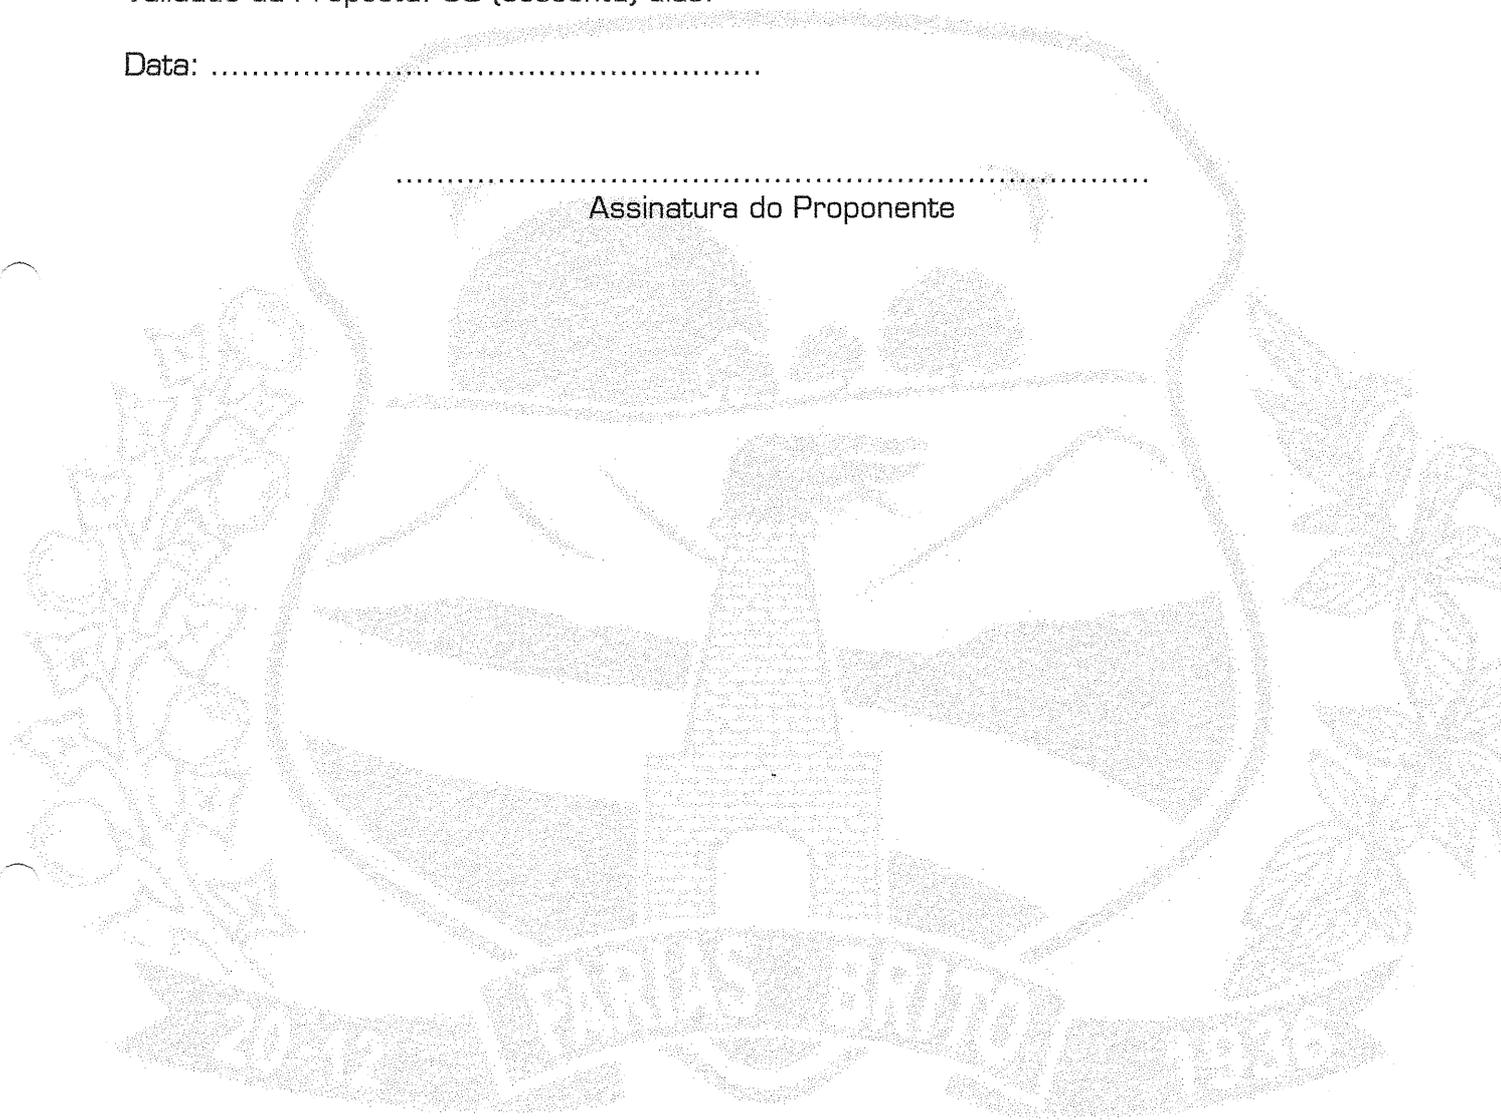



GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, **Pregão Eletrônico n.º 2022.02.24.1**, junto ao Município de Farias Brito/CE, que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Cidade/Estado,

.....
DECLARANTE



GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO


DECLARAÇÃO

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, **Pregão Eletrônico n.º 2022.02.24.1**, junto ao Município de Farias Brito/CE, que cumpre integralmente os requisitos para sua habilitação, conforme prescreve o inciso VII, do artigo 4º, da Lei n.º 10.520 de 17 de Julho de 2002, estando ciente das penalidades aplicáveis nos casos de descumprimento.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Cidade/Estado,

.....
DECLARANTE



GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

ANEXO V
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.º

Contrato que entre si celebram, de um lado o Município de Farias Brito/CE, através do(a), e do outro

O Município de Farias Brito, Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 07.595.572/0001-00, através do(a), neste ato representado pelo(a), o(a) Sr(a)., inscrito(a) no CPF n.º, apenas denominado de **CONTRATANTE**, e de outro lado, estabelecida na, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º, neste ato representada por, inscrito(a) no CPF n.º, apenas denominada de **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente Contrato, tendo em vista o resultado da Licitação na modalidade **Pregão Eletrônico n.º 2022.02.24.1**, tudo de acordo com as normas gerais da Lei n.º 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como com a Lei n.º 10.520/02 – Lei que Regulamenta o Pregão, na forma das cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. Processo de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 2022.02.24.1, de acordo com as normas gerais da Lei n.º 8.666/93, e suas alterações posteriores, bem como com a Lei n.º 10.520/02 – Lei que Regulamenta o Pregão, devidamente homologado pelo(a) Sr(a).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO


2.1. O presente Instrumento tem como objeto a aquisição de materiais e equipamentos destinados ao atendimento das necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Farias Brito/CE, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital Convocatório, nos quais a Contratada sagrou-se vencedora, conforme discriminado no quadro abaixo:

.....

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

3.1. O objeto contratual tem o valor total de R\$
 (.....).

3.2. O valor do presente contrato não será reajustado.



GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

3.3. Poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, desde que objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do Art. 65, Inciso II, alínea "d" da Lei 8.666/93, devendo ser formalizado através de ato administrativo.

3.4. Para a efetivação do que trata o item anterior, deverá a Contratada apresentar requerimento formal à Administração Municipal solicitando o reequilíbrio econômico-financeiro do(s) preço(s) do item(ns) que se fizer(em) necessário(s) para a justa remuneração do(s) fornecimento(s), devendo o referido pedido ser acompanhado da(s) nota(s) fiscal (is) de entrada da(s) mercadoria(s), do período compreendido entre a data da contratação e da solicitação, que será formalizado através de Termo Aditivo, cuja publicação do mesmo, em forma resumida, deverá ser providenciada pela Contratante, em obediência ao disposto no § único, do Art. 61, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL

4.1. O presente Contrato terá vigência até 31/12/2022, a contar da data de sua assinatura, ou enquanto decorrer o fornecimento dos produtos dentro da vigência do mesmo.

CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

5.1. Os produtos serão fornecidos de acordo com as solicitações requisitadas pela Secretaria/Fundo competente, devendo os mesmos ser entregues junto à sede desta, ou onde for mencionado nas respectivas Ordens de Compra, ficando a Administração no direito de solicitar apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessária, sendo as despesas com a entrega de responsabilidade da empresa Contratada.

5.2. Os produtos deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da respectiva Ordem de Compra.

5.3. A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, os produtos que vierem a ser recusados por justo motivo, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação.

5.4. A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto, sendo que os produtos deverão estar todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da data de industrialização e o prazo de validade, quando for o caso.

5.5. Caso a Prefeitura venha optar por entrega programada a contratada deverá dispor de instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos.

5.6. O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos:

5.6.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a especificação;

5.6.2. Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do produto, pelo setor responsável pela solicitação e conseqüentemente aceitação.

CLÁUSULA SEXTA – DA ORIGEM DOS RECURSOS



GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

6.1. As despesas deste Contrato correrão por conta de recursos oriundos do(e) Tesouro Municipal, previstos nas seguintes Dotações Orçamentárias:

.....

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento dos produtos fornecidos será efetuado pela Administração, mensalmente, obedecidas as requisições, em moeda corrente, conforme o valor apresentado na fatura correspondente e certificado pelo setor competente limitando-se o desembolso máximo em conformidade com a disponibilidade de recursos financeiros do Tesouro Municipal, em prazo não superior a 30 (trinta) dias.

7.2. O pagamento será efetuado através de Transferência Bancária.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada para fornecer o(s) produto(s)/bem(ns), objeto do presente Contrato, obrigar-se-á a:

8.1.1. Cumprir integralmente as disposições deste Instrumento e do Edital Convocatório.

8.1.2. Responsabilizar-se pela perfeição do(s) produto(s)/bem(ns) objeto deste Contrato, sendo ainda responsável por quaisquer danos pessoais ou materiais, inclusive contra terceiros, ocorridos durante seu fornecimento.

8.1.3. Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dívidas em favor de terceiros envolvidos na execução do objeto contratual, em particular no que se refere às contribuições devidas à Previdência Social, Obrigações Trabalhistas, Seguros e aos Tributos à Fazenda Pública em geral.

8.1.4. Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

8.1.5. Fornecer com presteza e dignidade o(s) produto(s)/bem(ns) objeto deste Contrato.

8.1.6. Aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem necessários na forma estabelecida no Art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada.

8.1.7. Entregar no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento da respectiva Ordem de Compra, os produtos requisitados pelo setor competente, devendo os mesmos ser entregues na sede da Secretaria/Fundo competente, ou no local indicado na antedita Ordem de Compra, sendo as despesas com a entrega de sua responsabilidade.

8.1.8. Trocar, as suas expensas, o(s) produto(s)/bem(ns) que vier(em) a ser recusado(s) por justo motivo, sendo que o ato de recebimento não importará em sua aceitação.

8.1.9. Efetuar a entrega do(s) produto(s)/bem(ns) em transporte adequado para tanto, sendo que os mesmos deverão estar todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da data de industrialização e o prazo de validade, quando for o caso.

8.1.10. Caso a Contratante venha optar por entrega programada a Contratada deverá dispor de instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos/bens pondo-os a salvo de possível deterioração.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. A Contratante obrigar-se-á a:



GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

9.1.1. Exigir o fiel cumprimento do Edital e deste Contrato, bem como zelo no fornecimento e o cumprimento dos prazos.

9.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do(s) produto(s) objeto deste Contrato.

9.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto a Contratada, através da Secretaria/Fundo Municipal contratante, a execução do objeto contratual.

9.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste Instrumento, bem como zelar pelo cumprimento de todas as cláusulas contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES

10.1. À Contratada total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções dos artigos 86 a 88 da Lei n.º 8.666/93, e suas demais alterações.

10.2. O Atraso injustificado na execução do contrato, inadimplemento, sujeitará a Contratada às seguintes sanções:

I – advertência, sanção de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.º 8.666/93, poderá ser aplicada nos seguintes casos:

a) descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas na licitação;
 b) outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da Contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.

II – multas (que poderão ser recolhidas em qualquer agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas Federais, por meio de Documento de Arrecadação Municipal – DAM, a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Contratante);

a) de 1% (um por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por dia de atraso na prestação dos serviços ou indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor;

b) de 2% (dois por cento) sobre o valor contratual total do exercício, por infração a qualquer cláusula ou condição do contrato, não especificada nas demais alíneas deste inciso, aplicada em dobro na reincidência;

c) de 5% (cinco por cento) do valor contratual total do exercício, pela recusa em corrigir qualquer serviço rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da comunicação formal da rejeição;


III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Farias Brito, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

10.3. A Prefeitura Municipal de Farias Brito, sem prejuízo das sanções aplicáveis, reterá crédito, promoverá cobrança judicial ou extrajudicial, a fim de receber multas aplicadas e resguardar-se dos danos e perdas que tiver sofrido por culpa da empresa Contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DA RESCISÃO

11.1. Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, por conveniência administrativa ou por infringência de qualquer das condições pactuadas.



GOVERNO MUNICIPAL
FARIAS BRITO
Uma Farias Brito para todos

11.2. O não cumprimento das disposições especificadas neste Contrato implicará automaticamente em quebra de Contrato, ensejando rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal 8.666/93, reconhecidos desde já os direitos da Administração, com relação as normas contratuais e as previstas em Lei ou Regulamento dispostas no presente Instrumento.

11.3. O presente contrato é rescindível ainda, independentemente de qualquer interpelação Judicial ou Extrajudicial, nos casos de:

11.3.1. Omissão de pagamento pela CONTRATANTE;

11.3.2. Inadimplência de qualquer de suas cláusulas por qualquer uma das partes;

11.3.3. Acerto em comum acordo por iniciativa de uma das partes, mediante aviso por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência, sem ônus para ambas as partes.

11.3.4. No caso de não cumprimento de qualquer das cláusulas deste contrato, a parte que se sentir prejudicada poderá rescindi-lo sem que se faça necessário uma comunicação por escrito com a antecedência definida no subitem anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

12.1. Quaisquer alterações que venham a ocorrer neste Instrumento serão efetuadas mediante Termo Aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

13.1. Este contrato deverá ser publicado por afixação em local de costume, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS ANEXOS

14.1. Integram o presente contrato todas as peças que formaram o procedimento licitatório, a proposta apresentada pela Contratada, bem como eventuais correspondências trocadas entre as partes, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1. O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato é o da Comarca de Farias Brito - CE.

Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva de acordo entre elas celebrado e, por assim estarem de acordo, assinam o presente Contrato as partes e as testemunhas abaixo firmadas.

Farias Brito/CE,

.....
CONTRATANTE

.....
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) CPF

2) CPF